## 目的

日本性機能学会臨床研究促進委員会が、

VCDの需要や必要性につき学会員を対象としたアンケート調査を行い、新たなVCDの開発における基本的な情報を得ることを目的とした。



#### 認知度

846名に対してアンケートを郵送し、 247名(29.1%)から回答 (陰茎プロステーシスに関しては15.8%からの回答)

Q: VCDをよく知っているか? (238名から回答)

A: よく知っている 138名 (58.0%)

名前は聞いたことがある 90名 (37.8%)

知らない 10名 (4.2%)

#### 認知度

846名に対してアンケートを郵送し、 **247名(29.1%)**から回答 (陰茎プロステーシスに関しては15.8%からの回答)

Q: VCDをよく知っているか? (238名から回答)

A: よく知っている 138名(58.0%)

名前は聞いたことがある 90名 (37.8%)

知らない 10名 (4.2%)



# ブランドの認知度

Q: 知っているVCDのブランドは? (複数回答)

A: カンキ 140名(56.7%)

ペトコ 91名 (36.8%)

リテント 58名 (23.4%)

オズボーン 3名 (1.2%)

エレックエイド 1名 (0.4%)





#### VCDの推奨度合い

Q: VCDをED患者に推奨しているか? (245名から回答)

A: 性交用補助器具として 29名 (11.8%)

術後の陰茎リハビリに 7名 (2.9%)

以前は推奨したが、今はしない 90名 (36.7%)

これまで推奨したことはない 119名 (48.6%)



#### VCDの推奨度合い

Q: VCDをED患者に推奨しているか? (245名から回答)

A: 性交用補助器具として 29名 (11.8%)


術後の陰茎リハビリに 7名 (2.9%)

以前は推奨したが、今はしない 90名(36.7%)

これまで推奨したことはない 119名 (48.6%)



# VCD使用患者から聞く評価

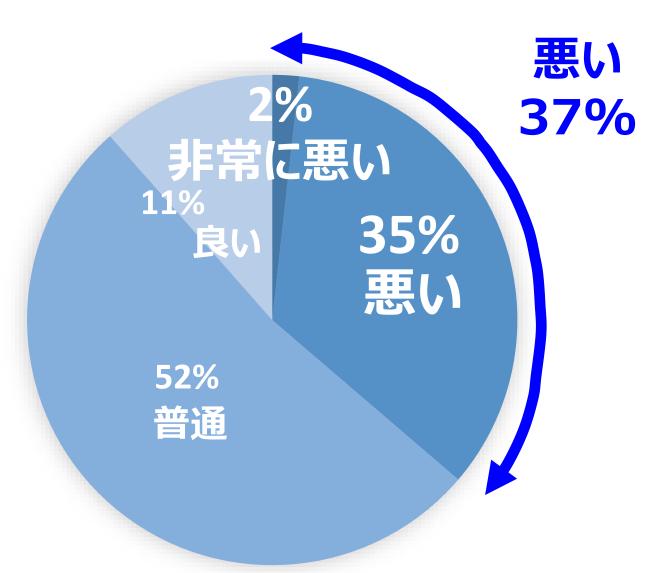



## VCD使用患者から聞く評価

具体的な意見

煩雑・操作困難 (陰毛巻き込み、など) ゴムリングのサイズが合わない ムードを壊す 持ち運びが面倒 効果不十分 勃起しても亀頭が冷たい 陰囊吸引、陰茎痛、射精障害 入手が困難 価格が高い

## VCDにネガティブな理由

Q: VCDを推奨しない理由は? (複数回答)

A: 希望者がいなかった 112名 (45.3%)

使用感が悪い 43名(17.4%)

病院で購入しづらい 39名(15.8%)

患者が購入しづらい 36名(14.6%)

価格が高い 20名 (8.1%)

効果が期待できない 14名 (5.7%)

#### VCDにネガティブな理由

Q: VCDを推奨しない理由は? (複数回答)

A: 希望者がいなかった 112名 (45.3%)

使用感が悪い

病院で購入しづらい

患者が購入しづらい

価格が高い

効果が期待できない

43名(17.4%)

39名(15.8%)


36名(14.6%)

20名 (8.1%)

14名 (5.7%)




# VCDがすべて製造中止

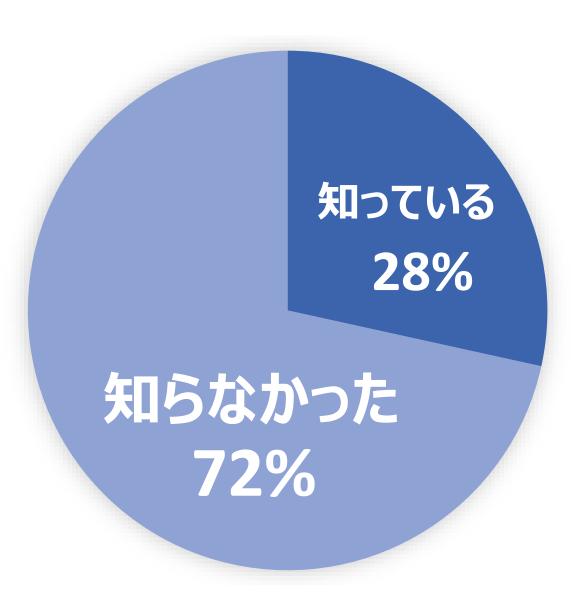




#### VCDが入手できない状況は困るか?

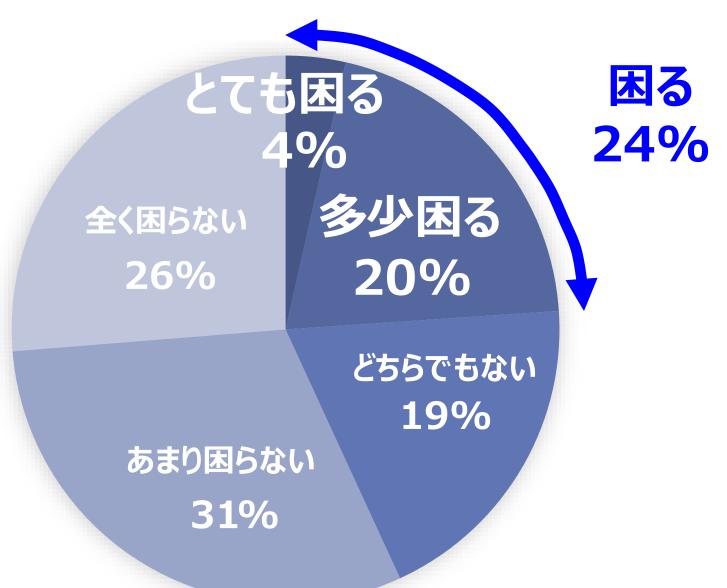



# 低価格で使用勝手・患者の使用感もよく、 効果も期待できるVCDが発売されたら、 必要とする患者に推奨するか?

推奨する 73%

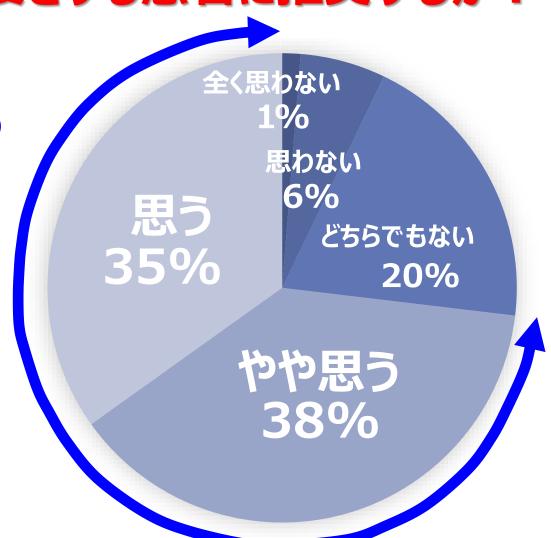



#### まとめ

- 1. 846名の会員のうち、247名 (29.1%) から回答
- 2. VCDを**よく知っている医師は約6割**
- 3. 1/3以上の医師は以前はVCDを推奨したが、今はしない
- 4. VCD使用患者からの使用感の評価は、悪いが約4割
- 5.全VCDが製造中止という現状を知らなかった医師が7割
- **6. 1/4の医師が**入手できない状況を困っている
- 7. 低価格で使用勝手・患者の使用感もよく、効果も期待できるVCDが発売されたら、7割以上の医師が患者に推奨する